

**FORMULARIO****FOR-CNSP-517****REPORTE DE RESULTADO FINAL DE ENSAYO DE APTITUD (EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO)****Edición N° 01****RESULTADO DEL ENSAYO DE APTITUD (EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO) PARA LA DETECCIÓN DE  
Anticuerpos frente al VIH**

Código del Laboratorio            NCV013  
Laboratorio Participante        LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DIRESA CUSCO  
Número de Lote (Evento)        2024-1  
Fecha Emisión Resultado        13/12/2024

**ENSAYO DE APTITUD (EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO SEROLOGÍA)  
PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A VIH**

Responsable Emisión Reporte            Soledad Romero Ruiz

*LABORATORIO DE VTS  
Av. Defensores del Morro 2220  
Chorrillos - Lima - Perú  
0  
sromero@ins.gob.pe*

**FORMULARIO****FOR-CNSP-517****REPORTE DE RESULTADO FINAL DE ENSAYO DE APTITUD (EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO)****Edición N° 01**

Estimados usuarios, se sugiere leer atentamente el siguiente instructivo de interpretación de resultados, antes de proceder a su análisis.

**PARTE 1: DE LOS RESULTADOS**

N°: El primer cuadro, indica el número de muestra del programa y las representa con código de colores.

Código de Muestra: Este cuadro indica con un código la prueba a realizar y el número de muestra del evento, al lado del código literal.

N: Indica el total de laboratorios participantes.

VP = Verdaderos Reactivos Globales

VN = Verdaderos No Reactivos Globales

FN = Falsos No Reactivos Globales

FP = Falsos Reactivos Globales

Consenso: Indica el acuerdo consenso de cada una de las muestras del evento, el cual se obtiene a partir de un 80% de concordancia en los resultados obtenidos por todos los laboratorios participantes.

Su Resultado: Indica el resultado que su laboratorio reportó para cada una de las muestras del evento.

Concordancia: Indica el grado de acuerdo existente entre lo reportado por el laboratorio y el consenso de los laboratorios participantes para determinada muestra; sin embargo, al tratarse valores cualitativos (Reactivo o No Reactivo) sólo existen dos posibilidades, o se obtiene 100% de concordancia, o se obtiene 0% de concordancia.

Desempeño: Califica la participación del laboratorio como Satisfactorio (si se tiene 100% de concordancia con el consenso) o Insatisfactorio (Si se tiene 0% de concordancia con el consenso).

Resultado Total de Concordancia%: Indica en porcentaje el número de resultados que el laboratorio reportó y que concuerdan 100% con el consenso.

Desempeño Global: Califica el desempeño del laboratorio como Satisfactorio, si es que el 80% (4 resultados correctos de un total de 5) de los resultados emitidos por el laboratorio concuerdan con los resultados del Consenso, o Insatisfactorio si el consenso frente al grupo es < 80%.

**PARTE 2: DE LOS GRÁFICOS DE BARRA**

El gráfico de barras refleja el desempeño de todos los laboratorios participantes en cada una de las muestras del evento. El eje de las Ordenadas (Y) representa la cantidad de laboratorios participantes en el evento. El eje de las Abscisas (X) representa los posibles resultados. Se podrían llegar a observar una o más barras de acuerdo a los resultados reportados por los laboratorios participantes. El triángulo negro indica en dónde se ubica el resultado que su laboratorio reportó en una muestra determinada.

**PARTE 3: DE LOS GRÁFICOS DE PASTEL**

Estos gráficos expresan en porcentaje la cantidad de resultados obtenidos de todos los participantes en este evento para cada una de las muestras, nos indica el porcentaje de VP, VN, FN o FP que ha obtenido una muestra determinada.

**PARTE 4: DE LA PUNTUACIÓN SCORE**

La puntuación Score, permite calificar de forma proporcional el acierto o error en el que ha incurrido el laboratorio participante, de tal manera que se puede representar este desempeño en una gráfica Levey-Jenings.

Cuando se habla en términos de proporcionalidad, se hace referencia a la gravedad del error que el laboratorio ha cometido, siendo así, un Falso No Reactivo (FN) representa el mayor de los errores en el que un laboratorio puede incurrir, motivo por el cual se le da una calificación de -10, mientras que un resultado Falso Reactivo Borderline o no Borderline, representa un error menor, siendo sus calificaciones respectivas de 2 y 6.



FORMULARIO

FOR-CNSP-517

REPORTE DE RESULTADO FINAL DE ENSAYO DE APTITUD (EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO)

Edición N° 01

RESULTADO DEL ENSAYO DE APTITUD (EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO) PARA LA DETECCION DE Anticuerpos frente al VIH

Código de Identificación

NCV013

LABORATORIO:

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DIRESA CUSCO

METODOLOGÍA:

ELISA VIH, IFI VIH-1

FECHA DEL EVENTO:


Nov-24

2024-1

RESULTADOS

No	Código de la Muestra	N	VP	VN	FN	FP	Consenso	Su Resultado	Concordancia(%)	Desempeño
1	VTS- 01	21	20	0	0	0	Reactivo	Reactivo	100%	Satisfactorio
2	VTS-02	21	21	0	0	0	Reactivo	Reactivo	100%	Satisfactorio
3	VTS-03	21	0	21	0	0	No Reactivo	No Reactivo	100%	Satisfactorio
4	VTS-04	21	21	0	0	0	Reactivo	Reactivo	100%	Satisfactorio
5	VTS-05	21	21	0	0	0	Reactivo	Reactivo	100%	Satisfactorio
<b>Resultado Total Concordancia %</b>									100%	
<b>Desempeño Global</b>									Satisfactorio	

Su resultado

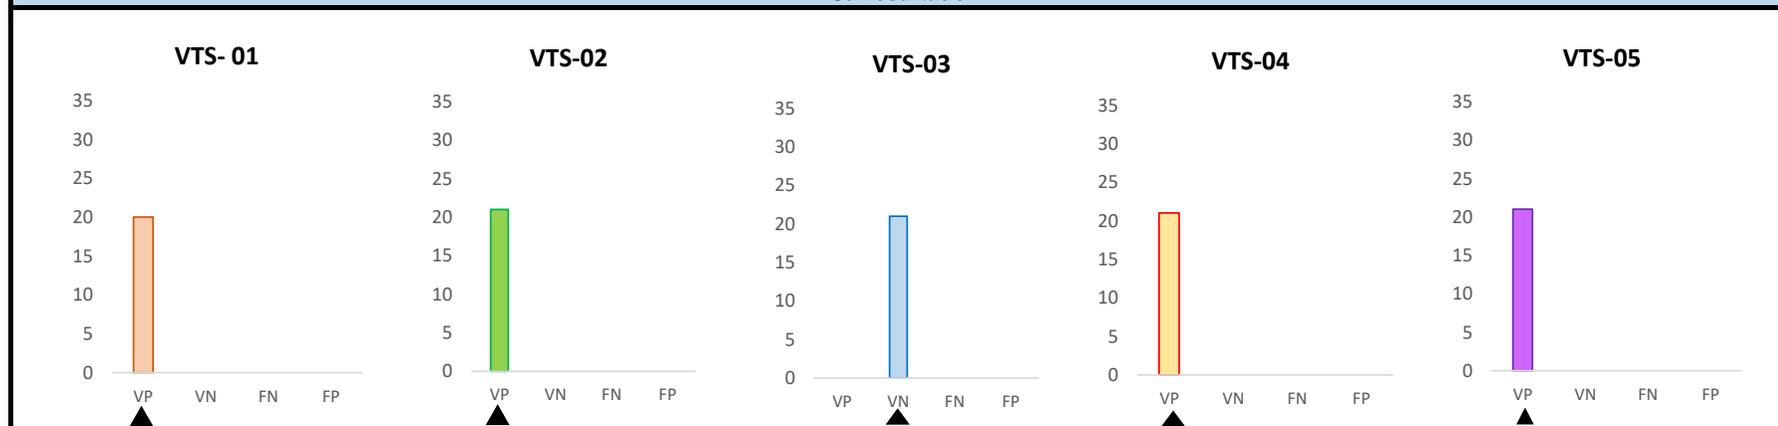



FORMULARIO

FOR-CNSP-517

REPORTE DE RESULTADO FINAL DE ENSAYO DE APTITUD (EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO)

Edición N° 01

RESULTADO DEL ENSAYO DE APTITUD (EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO) PARA LA DETECCIÓN DE

Anticuerpos frente al VIH

Código de Identificación

NCV013

LABORATORIO:

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DIRESA CUSCO

METODOLOGÍA:


ELISA, IFI VIH-1

FECHA DEL EVENTO:

Nov-24

2024-1


Resultado Consenso

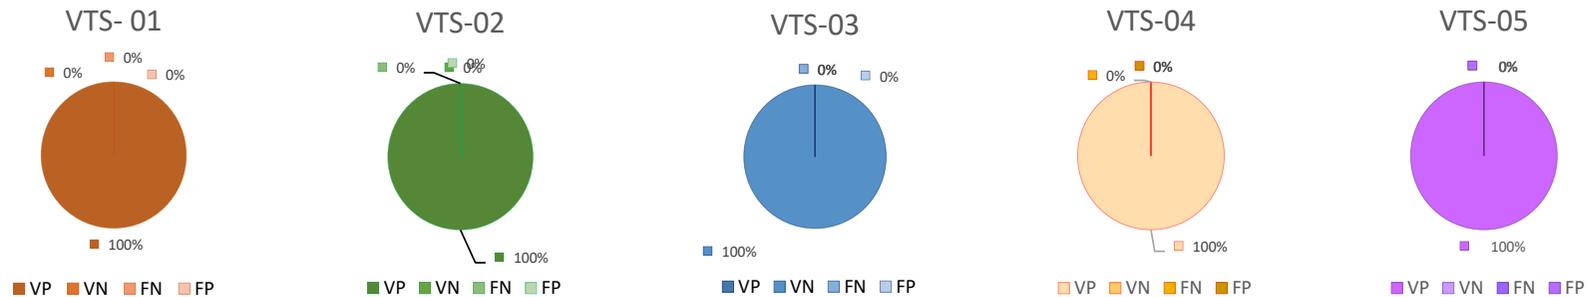

Puntuación Score

Código Control	[%DEV]
VTS- 01	0
VTS-02	0
VTS-03	0
VTS-04	0
VTS-05	0

Interpretación	Puntuación
Verdadero Reactivo	0
Verdadero No Reactivo	0
Falso Reactivo Borderline	2
Falso Reactivo No Borderline	6
Falso No Reactivo	-10

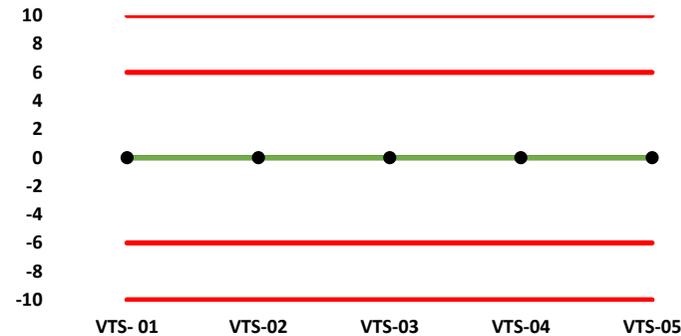

Observaciones:

Firma del Evaluador de PEI

Firma del responsable del LRN VTS-INS



Blga. Soledad Romero

Blga. Maribel Acuña